

SANXIN

SX726 型
电导率/溶解氧测量仪

使用说明书

上海三信仪表厂

SX700 系列便携式测量仪

1. SX711 型 pH/mV 计
2. SX712 型 ORP 计
3. SX713 型电导率/TDS/盐度/电阻率测量仪
4. SX716 型溶解氧测量仪
5. SX721 型 pH/ORP 计
6. SX723 型 pH/mV/电导率测量仪
7. SX725 型 pH/mV/溶解氧测量仪
- 8. SX726 型电导率/溶解氧测量仪**
9. SX731 型 pH/ORP/电导率测量仪
10. SX736 型 pH/mV/电导率/溶解氧测量仪
11. SX751 型 pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪

目 录

1. 概述 -----	3
2. 技术参数 -----	4
3. 仪器说明 -----	5
3.1. LCD 显示 -----	5
3.2. 操作键 -----	6
3.3. 测量信息的储存、回显和清除 -----	7
4. 电导率测量 -----	8
4.1. 准备工作 -----	8
4.2. 仪器校准 -----	8
4.3. 溶液测试 -----	8
4.4. 重要说明 -----	8
4.5. 参数设置 -----	10
4.6. 注意事项 -----	14
5. 溶解氧测量 -----	14
5.1. 准备工作 -----	14
5.2. 仪器校准 -----	15
5.3. 水样测试 -----	16
5.4. 注意事项 -----	16
5.5. 参数设置 -----	17
5.6. 更换隔膜帽 -----	19
5.7. 零氧校准 -----	20
5.8. 盐度校准 -----	20
5.9. 气压设置 -----	20
6. 仪器成套性 -----	21
7. 仪器保证事项 -----	22
附表 I 仪器参数设置一览表	
附表 II 仪器恢复出厂设置一览表	
附表 III 代码符号及缩写一览表	
附表 IV 氧在不同温度水中的饱和含量	
附表 V 氧在不同气压中的饱和含量	
附表 VI 氧在不同海拔高度中的饱和含量	

1. 概述:

感谢您购买和使用 SX726 型电导率/溶解氧测量仪（以下简称仪器）。

在您使用此仪器前，请仔细阅读使用说明书，以帮助您正确使用和维护。基于不断改良仪器性能之宗旨，本厂保留在不预先通知的情况下对本说明书内容及配件进行更改的权利。

本仪器是先进的电子技术、传感器技术和软件设计的完美结合。本仪器可用于高精度测量水溶液的电导率、TDS、盐度、电阻率、溶解氧和温度等参数，是性价比最优的便携式水质分析仪器。适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等行业，尤其适合在野外和现场使用。

本仪器内置微处理器芯片、外型美观、功能丰富、使用方便，具有下列显著特点：

1. 1. 双参数仪表，配置电导电极和溶氧电极，以及校准溶液和专用手提箱，使用方便。
1. 2. 内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自动关机和低电压显示等智能化功能。
1. 3. 采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性，测量值稳定时显示“”图标。
1. 4. 采用先进的自动变频和自动调压技术，使常数 K=1 的电导电极的测量范围扩展 10 倍，只需一点校准，即可满足 0~100 mS/cm 范围内的测量精度要求，是本仪器独特的一点校准功能。
1. 5. 自动识别 8 种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和中国系列。
1. 6. 自动选择电导率测量量程，对小于 10 μ S/cm 的纯水和高纯水，仪器自动进行非线性温度补偿，大大提高了高纯水电导率的测量准确度，特别适合电力、微电子和

医药行业的使用。

1. 7. 配用新型的带有温度和盐度传感器的溶氧电极，使溶解氧测量模式具有自动温度补偿、自动盐度补偿和手动气压补偿的功能，使用更方便，测量更准确。
1. 8. 极谱式溶解氧电极，配以专用的溶解氧电极校准套，电极极化只需 (3~5) min。电极采用组合式隔膜帽，使用极其方便。每支溶解氧电极配有三个备用隔膜帽。
1. 9. 仪器电路板采用 SMT 贴片工艺，提高了产品加工的可靠性。
1. 10. 带蓝色背光的 LCD 显示屏。
1. 11. 仪器符合 IP57 防尘防水等级。

2. 技术参数：

2. 1. 电导率：

测量范围	电导率：(0.00~19.99) $\mu\text{S}/\text{cm}$ (20.0~199.9) $\mu\text{S}/\text{cm}$ (200~1999) $\mu\text{S}/\text{cm}$ (2.00~19.99) mS/cm (20.0~199.9) mS/cm
TDS:	(0 ~ 100) g/L
盐度:	(0 ~ 100) ppt
电阻率:	(0 ~ 100) $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$
分辨率	0.01/0.1/1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 0.01/0.1 mS/cm
精确度	电计: $\pm 1.0\%$ FS, 配套: $\pm 1.5\%$ FS
温度补偿范围	(0 ~ 50) °C (自动)
电极常数	0.1 / 1 / 10 cm^{-1}
基准温度	25°C、20°C 和 18°C

2. 2. 溶解氧：

测量范围	(0 ~ 40.00) mg/L (ppm) (0 ~ 200.0) %
分辨率	0.1/0.01 mg/L (ppm) 1/0.1 %
准确度	电计: ± 0.10 mg/L, 配套: ± 0.40 mg/L

响应时间	≤ 30 s (25°C, 90% 响应)
残余电流	≤ 0.1 mg/L
温度补偿范围	(0 ~ 45) °C (自动)
盐度补偿范围	(0 ~ 45) ppt (自动)
气压补偿范围	(66 ~ 200) kPa (手动)
自动校准	被水饱和的空气；被空气饱和的水
电极类型	极谱式

2.3. 其他技术参数:

数据储存	200 组
储存内容	编号、测量值、测量单位和温度值。
电源	AA 电池 2 节 (1.5V × 2)
尺寸和重量	仪表: (65×120×31) mm/180g ; 手提箱: (360×270×76) mm/1.6Kg
质量和安全认证	ISO9001:2000, CE 和 CMC

2.4. 工作条件:

环境温度	5 ~ 35 °C (0.01 级)
环境湿度	$\leq 85\%$
IP 等级	IP57 防尘防水

3. 仪器说明:

3.1. LCD 显示:



- ① —— 参数模式图标
- ② —— 测量值
- ③ —— 测量值储存及回显的编号和图标；以及特殊状态的提示符号。

M+ — 测量值储存图标； RM — 测量值回显图标；

- ④ —— 测量单位
- ⑤ —— 温度测量值及单位
- ⑥ —— 测量值稳定图标
- ⑦ —— 仪器校准指示图标
- ⑧ —— 低电压显示图标，当电池电压低于 2.4V 时显示此符号，提醒更换电池。

3. 2. 操作键：

仪器共有 5 个操作键

3.2.1.  — 开关键

3.2.2.  — 校准键

(a) 在测量状态时，按键进入仪器校准模式。

(b) 在参数设置状态时，按键改变数字或 ON/OFF 状态。

3.2.3.  — 功能键

(a) 短按 (按键时间<1.5s) 改变测量参数依次显示 **COND** (电导率) 和 **DO** (溶解氧)

(b) 长按 (按键时间>2 s) 进入参数设置模式 P1，然后再短按，依次显示 P2, P3

3.2.4.  — 背光和进入键

(a) 在测量状态时，短按 (按键时间<1.5s)，开启或关闭背光显示；

(b) 在校准状态或参数设置状态时，按键表示确认，按键后仪器进入测量状态；

(c) 在 **COND** 模式时，按键不放，循环改变参数模式：**TDS** (可溶解固体总量) →

SAL (盐度) → **RES** (电阻率) → **COND** (电导率), 选定后放开即可。

(d) 在 **DO** 模式时, 按键不放, 循环改变单位符号: mg/L→ppm→%, 选定后放开即可。

3.2.5. — 储存和回显的复合键

(a) 在测量状态时, 短按 (按键时间<1.5s) 储存测量数据, 长按 (按键时间>2s), 回显储存的测量数据。

(b) 在参数设置状态时, 按键改变数字或 ON/OFF 状态。

3.3. 测量信息的储存、回显和清除:

3.3.1. 储存测量信息:

在测量模式下, 当测量值已稳定, 显示“”图标时, 短按  键 (按键时间<1.5s), LCD 将显示“M+”图标和储存编号, 同时将测量信息全部储存。仪器在电导率和溶解氧测量模式中可分别储存 100 组测量信息, 总计可以储存 200 组。

3.3.2. 回显测量信息:

(a) 在测量模式下, 长按  键 (按键时间>2s), 仪器将回显最后一组储存的信息, LCD 右上角显示储存编号和“RM”图标, 以及完整的测量信息, 再按  键或  键, 仪器将依次回显所有的测量信息, 长按  或  键, 可快速查询;

(b) 在回显模式下 (LCD 右上角有“RM”图标和储存编号), 按  键将返回测量模式。

3.3.3. 清除储存的测量信息:

在回显模式下, 长按  键 5 s, LCD 显示“”符号 2 s, 表示内存已清除, 然后返回测量模式。

4. 电导率测量:

4. 1. 准备工作:

- 4.1.1. 按  键开机；
- 4.1.2. 短按  键切换至 **COND** 模式，长按  键循环改变 **TDS** (可溶解固体总量), **SAL** (盐度), **RES** (电阻率) 和 **COND** (电导率)，选定后放开即可。
- 4.1.3. 将 2301-S 电导电极接入仪器。

4. 2. 仪器校准:

按  键，LCD 右上角 “*CAL*” 闪烁，提示进入校准模式，将电导电极在纯水中洗净并甩干，浸入 $1413 \mu\text{S}/\text{cm}$ 校准溶液中，搅动后静止放置，等测量值稳定并显示 “” 图标时，再按  键，LCD 显示闪烁的 “ $1413 \mu\text{S}/\text{cm}$ ”，几秒钟后显示 “*End*” 符号并返回测量模式，此时 LCD 显示稳定的测量值 $1413 \mu\text{S}/\text{cm}$ 和校准指示符号 “”，提示校准完成。如果测量值不稳定，可重复校准直至稳定。

注意：(1) 仪器出厂时已进行校准，一般情况下可直接使用。

(2) 仪器只有在 **COND** 模式下才能校准，在 **RES**、**TDS** 和 **SAL** 模式下不能校准，必须切换到 **COND** 模式，校准完成后切换回来。

4. 3. 溶液测试:

- 4.3.1. 将电导电极洗净并甩干，放入溶液中，搅动后静止放置，等测量值稳定并显示 “” 图标时读数，即为该溶液的电导率值。
- 4.3.2. 按住  键不放，可循环显示与电导率值对应的 **TDS** 值、盐度值和电阻率值，选定后放开即可。

4. 4. 重要说明:

4.4.1. 本仪器内存以下二种校准溶液系列, 请在参数设置 P1 中设定;

(a) **CH** (中国系列) — $146.6 \mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $1408 \mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $12.85 \text{mS}/\text{cm}$ 和 $111.3 \text{mS}/\text{cm}$

(b) **USA** (欧美系列) — $84 \mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $1413 \mu\text{S}/\text{cm}$ 、 $12.88 \text{mS}/\text{cm}$ 和 $111.9 \text{mS}/\text{cm}$

4.4.2. 本仪器具备独特的一点校准功能, 可按水样和校准溶液的电导率尽量接近的原则选择一种校准溶液进行校准, 一般常用的校准溶液是 $1413 \mu\text{S}/\text{cm}$, 使用本仪器配套的 2301-S 电导电极 ($K = 1 \text{ cm}^{-1}$), 用 $1413 \mu\text{S}/\text{cm}$ 校准溶液进行校准, 可以在小于 $100 \text{mS}/\text{cm}$ 的测量范围内使用。请参考表 (4-1) 进行选择。

表 (4-1)

测量范围	$0.05 \sim 20 \mu\text{S}/\text{cm}$	$0.5 \mu\text{S}/\text{cm} \sim 200 \text{mS}/\text{cm}$		
电极常数	$K=0.1 \text{cm}^{-1}$ (流动测试)	$K=1.0 \text{cm}^{-1}$		
校准溶液	$84 \mu\text{S}/\text{cm}$	$84 \mu\text{S}/\text{cm}$	$1413 \mu\text{S}/\text{cm}$	$12.88 \text{mS}/\text{cm}$ $111.9 \text{mS}/\text{cm}$
校准指示图标				

4.4.3. 仪器设置的电导电极校准方法有标准溶液校准法和常数设定法二种, 第 4.2. 条“电极校准”所述即为标准溶液校准法, 只要标准溶液是准确的, 它就能保证最好的准确度, 因此建议优先选用标准溶液校准法。用户如习惯采用常数设定法, 即根据电导电极上标注的常数值进行设定的方法, 请在参数设置 P5 中进行(参见 P12 第 4.5.6. 条)。二种校准方法可以任意选用, 不会相互影响。当采用常数设定法时, LCD 不显示校准指示图标。

4.4.4. 仪器出厂设置的温度补偿系数是 $2.0\%/\text{C}$, 但是各种不同种类和不同浓度溶液的电导率温度系数各不相同, 用户可参考表 (4-2) 以及自己在实验中得到的数据, 在参数设置 P4 中进行设定。在低于 $10 \mu\text{S}/\text{cm}$ 的高纯水中, 仪器自动进行非线性温度补偿。

注意, 当将温度补偿系数设置为 0.00 时, 即仪器测试时无温度补偿, 仪器的

测量值是当时温度下的电导率。

表 (4-2)

溶 液	温度补偿系数
NaCl 盐溶液	2. 12 %/℃
5%NaOH 溶液	1. 72 %/℃
稀氨水溶液	1. 88 %/℃
10%盐酸溶液	1. 32 %/℃
5%硫酸溶液	0. 96 %/℃

4.4.5. 仪器的其它参数设置内容, 请参见表 (4-3)。

4.4.6. 特别注意: 当参数设置内容与出厂设置内容一致时, 电导率测量界面如图 (4-1) 所示, 当部分参数设置内容与出厂设置内容不同时, 电导率测量界面如图 (4-2) 所示, LCD 右上角显示代码符号, 当设置过二个以上有代码符号的参数时, LCD 只能显示其中的一个代码符号, 使用者应进入参数设置界面仔细查看已设置的内容, 或者将仪器恢复到出厂设置, 再重新设置需要的参数。



图 (4-1)

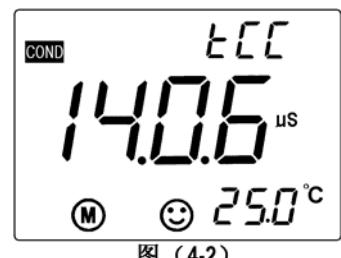


图 (4-2)

4. 5. 参数设置:

4.5.1. 电导率测试参数设置一览表 (表 (4-3))

表 (4-3)

提示符	参数设置项目	代码	参数
P1	标准溶液系列选择	SOL	USA (84 μS/cm、 1413 μS/cm、 12.88mS/cm、 111.9 mS/cm) CH (146.6 μS/cm、 1408 μS/cm、 12.85mS/cm、 111.3 mS/cm)

P2	电极常数选择	<i>Con</i>	0.1, , 1, 10.
P3	基准温度选择	<i>rEF</i>	25℃ 20℃ 18℃
P4	温度补偿系数设置	<i>TCC</i>	0.00~9.99%
P5	电极常数设定	<i>CC</i>	
P6	温度单位选择		℃ °F
P7	背光显示时间设置	<i>BL</i>	0-1-3-6 min
P8	自动关机时间设置	<i>AC</i>	0-10-20 min
P9	恢复出厂设置		OFF-On (关闭-设置)

4.5.2. 电导率校准溶液系列选择 (P1)

(a) 长按 **MODE** 键，仪器进入 P1 模式，如图 (4-3) 所示；

(b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键选择标准溶液系列：

CH — 中国系列 *USA* — 欧美系列

(c) 按 **MODE** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认

并返回测量模式。

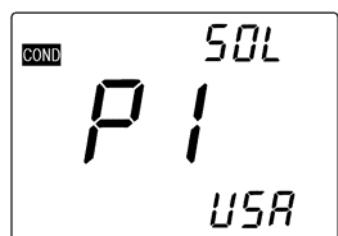


图 (4-3)

4.5.3. 电极常数选择 (P2)

(a) 在 P1 模式下短按 **MODE** 键进入 P2 模式；如图 (4-4) 所示；

(b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键改变常数设置：0.1→1.0→10.0

(c) 按 **MODE** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认并

返回测量模式。



图 (4-4)

(d) P2 的出厂设置为 K = 1.0。

4.5.4. 基准温度选择 (P3)

(a) 在 P2 模式下短按 **MODE** 键进入 P3 模式；如图 (4-5) 所示；

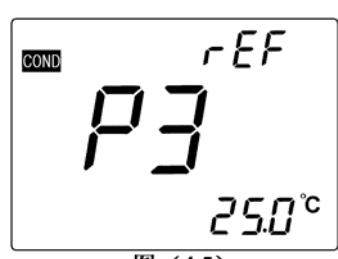


图 (4-5)

所示；

- (b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键选择基准温度： $25^{\circ}\text{C} \rightarrow 20^{\circ}\text{C} \rightarrow 18^{\circ}\text{C}$ ；
- (c) 按 **MODE** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认并返回测量模式。
- (d) P3 的出厂设置为 25°C 。

注意：如果将基准温度更改为 20°C 或 18°C ，在测量模式时，LCD 右上角会显示“*rEF*”符号。

4.5.5. 温度补偿系数设置 (P4)

- (a) 在 P3 模式下短按 **MODE** 键进入 P4 模式，如图 (4-6) 所示；
- (b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键改变大小，数字改变范围：
0.00~9.99；长按 **CAL** 键或 **M+ RM** 键，可快速改变。

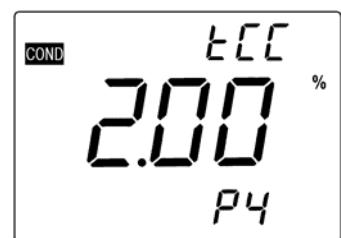


图 (4-6)

注意：当设定数字为 0.00 时，表示没有温度补偿，参见 P9 第 4.4.4. 条；

- (c) 按 **M+ RM** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认并返回测量模式。
- (d) P4 的出厂设置是 2.0%。

注意：如果将温度系数更改为其他数值，在测量模式时，LCD 右上角会显示“*TCC*”符号。

4.5.6. 电极常数设定 (P5)，参见 P9 第 4.4.3. 条。

- (a) 在 P4 模式下短按 **MODE** 键进入 P5 模式，LCD 显示前一次校准的常数值，例如 0.96 cm^{-1} ，如图 (4-7) 所示；
- (b) 按 **CAL** 键或 **M+ RM** 键修改大小，根据电导电极上标记的常数值进行设定；
- (c) 按 **MODE** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认并返回测量模式。
- (d) 如需对常数 1 以外的电导电极进行常数校准，例如使用常数 10.3 的电导电极，

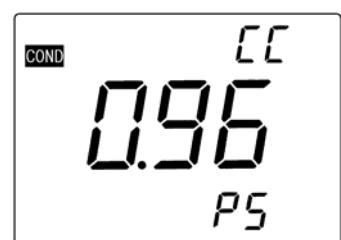


图 (4-7)

应先进入常数设置 P2 中设定常数“10”，然后再进入 P5 模式将常数值设定为 10.3。

4.5.7. 温度单位℃/°F选择 (P6)

- (a) 在 P5 模式下按 **MODE** 键，进入 P6 模式，见图 (4-8)。
- (b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键可选择温度单位℃或°F。
- (c) 按 **MODE** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认并返回测量模式。



图 (4-8)

4.5.8. 背光显示时间设置 (P7)

- (a) 在 P7 模式下按 **MODE** 键，进入 P7 模式，见图 (4-9)。
- (b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键，选择背光自动关机的时间：0min, 1min, 3min 或 6min，选择 0 min 表示关闭背光显示功能。
- (c) 按 **MODE** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认并返回测量模式。

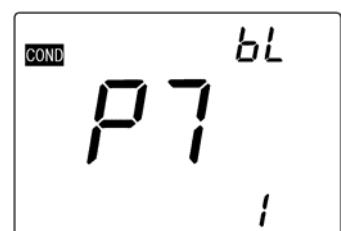


图 (4-9)

4.5.9. 自动关机时间设置 (P8)

- (a) 在 P7 状态下按 **MODE** 键，进入 P8 模式，见图 (4-10)。
- (b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键，选择仪表自动关机的时间：0min, 10min 或 20min，选择 0 min 表示仪表自动关机功能关闭。
- (c) 按 **MODE** 键进入下一项参数设置或按 **ENTER** 键确认并返回测量模式。

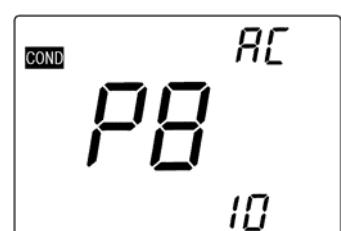


图 (4-10)

4.5.10. 恢复出厂设置 (P9)

- (a) 在 P8 模式下按 **MODE** 键，进入 P9 模式，见图 (4-11)。

(b) 按 **CAL** 或 **M+ RM** 键选择 “**On**”，表示恢复出厂设置模式，2s 后返回测量模式。



图 (4-11)

4.6. 注意事项：

- 4.6.1. 仪器出厂时已对电导电极进行校准，一般情况下用户可直接使用；
- 4.6.2. 正常情况下推荐每月校准一次；新购的电导电极，以及使用一段时间后的电导电极应进行校准；
- 4.6.3. 保持电导电极的清洁，测量前后要用纯水冲洗电极并甩干，最好再用被测溶液冲洗电极；
- 4.6.4. 2301-M 电导电极的感应棒表面镀有一层金属铂黑，用以降低电极极化，扩大量程，因此铂黑电极表面不能擦拭，只能在水中晃动清洗，以免损坏铂黑镀层；用含有洗涤剂的温热水可以清洗电极上有机成分沾污，也可以用酒精清洗。
- 4.6.5. 电导电极使用前可浸在纯水中，以防止铂黑的惰化，如发现镀铂黑的电极失灵，可浸入 10% 硝酸溶液或 10% 盐酸溶液中 2min，然后用纯水冲洗干净再测量，如情况并无改善，则铂黑要重新电镀，或更换新的电导电极。
- 4.6.6. 当仪器出现不正常时，请设置 P9 为 “On”，使仪器恢复出厂设置状态，再进行校准和测试。

5. 溶解氧测量：

5.1. 准备工作：

- 5.1.1. 按 **ON OFF** 键开机；短按 **MODE** 键切换至 “**DO**” 模式，
- 5.1.2. 选择单位：长按 **ENTER** 键循环改变 mg/L、ppm 和 %，选定后放开即可。

5.1.3. 检查 DO500 溶解氧电极：见图 (5-1) ,将电极校准套底盖旋下，检查其中的储水海绵是否湿透，如未湿透，要滴加适量纯水，然后将校准套倒置去除多余纯水（注意校准套中不能有积水）；再检查电极隔膜帽内的电解液不能有气泡（较小气泡除外），如有较大气泡，应将隔膜帽旋下，添加电解液后再旋上，然后将电极接入仪器中，极化 15min。

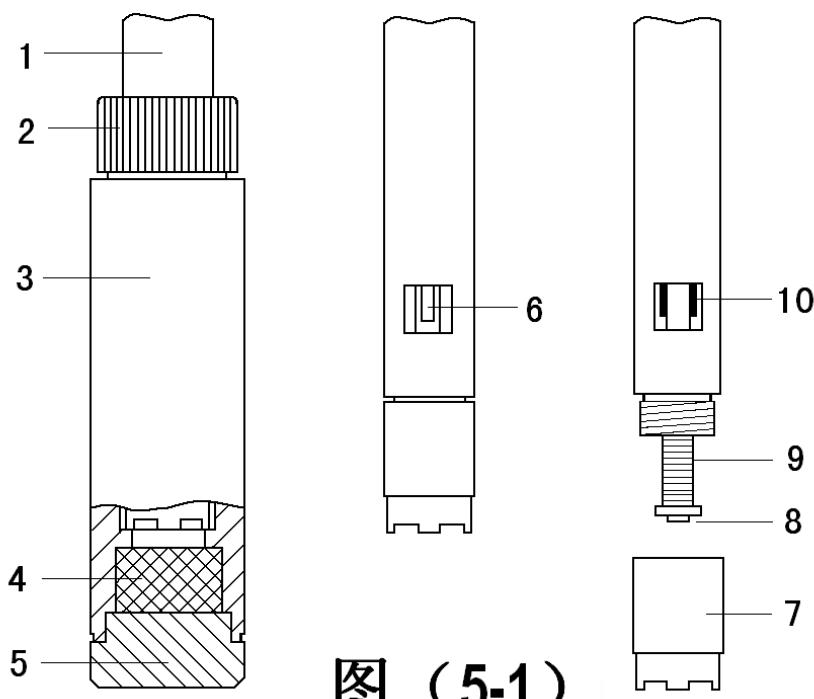


图 (5-1)

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 — DO500 溶解氧电极 | 6 — 温度电极 |
| 2 — 校准套帽子 | 7 — 隔膜帽 |
| 3 — 校准套 | 8 — 阴极 (黃金片) |
| 4 — 储水海绵 | 9 — 阳极 |
| 5 — 校准套底盖 | 10 — 盐度电极 |

5. 2. 仪器校准：

5.2.1. 按 **CAL** 键仪器进入校准模式，LCD 右上角 “CAL” 闪烁，将溶解氧电极插入校准套中，旋紧校准套帽子，竖直放置并等待 3~5 min，或者将电极取出竖直放置在空气中并等待 3~5 min，待显示值很稳定并出现 “” 符号时，再按

CAL 键校准, LCD 显示闪烁的“100%”, 几秒钟后校准完成, 返回测量模式。

如果显示值不稳定, 可以等待几分钟, 再按 **CAL** 键校准直至完全稳定。

5.2.2. 校准时建议将单位切换至“%”, 因为“%”模式其显示值和温度无关, 稳定的显示值总是 100%。

5.3. 水样测试:

5.3.1. 在流动水体中测量 (水样流速>5cm/s): 将溶解氧电极插入水中, 水面应超过电极上的热敏电阻的位置, 电极与水流方向呈 $45^{\circ} \sim 75^{\circ}$, 并轻微晃动电极, 持续 3~5 min 待显示稳定后读数;

5.3.2. 在静态水体中测量: 将溶解氧电极插入水中, 水面应超过电极热敏电阻的位置, 电极与水面呈 $45^{\circ} \sim 75^{\circ}$, 将电极在水体中快速移动, 移动速度>5 cm/s, 持续 3~5 min 待显示稳定后读数;

5.3.3. 在流动较慢的水体中测试: 按第 5.3.1. 条的方法, 但电极移动速度要稍快。

5.4. 注意事项:

5.4.1. 校准时空气温度和被测水体的温度应比较接近 ($<10^{\circ}\text{C}$), 如果温度相差较大, 应将电极在被测水体中浸 10 分钟左右, 然后马上按第 5.2.1. 条要求将电极插入校准套中 5~6min, 再按 **CAL** 键校准即可。

5.4.2. 仪器每次开机后都要进行电极极化和校准, 因此仪器在使用过程中不要关机(溶解氧测量模式时, 仪器自动关机时间的出厂设置为 0, 即自动关机的功能关闭)。

5.4.3. 溶解氧测试中温度对测量值的影响比较大, 由于溶解氧电极的热敏电阻装在电极外壳上, 直接与水体接触, 而不是装在电极内部的电解液中, 二者对水体温的感应能力是有差异的, 一般要经过 3~5 min 才能使热敏电阻感应的温度和电极内部电解液的实际温度达到一致, 因此读数时间必须>3min, 否则会产生较大误差, 尤其当电极温度和水体温度相差较大时, 更要延长读数时间。

- 5.4.4. 大气压对溶解氧测试有较大的影响（参见附表V和附表VI），本仪器有手动气压补偿功能，测量值经过气压补偿的修正，可以保证准确度。
- 5.4.5. 溶解氧电极不能在静态水体中静止测试，否则将导致测试结果数值偏低。
- 5.4.6. 测量时，溶解氧电极与水体接触的敏感膜表面不能积聚气泡，否则会影响测试精度。
- 5.4.7. 电极内部的电解液中不能有气泡（较小的气泡除外），否则会影响响应速度和测量精度。如果出现较大大气泡，应将隔膜帽旋下，添加电解液后再旋上。
- 5.4.8. 溶解氧电极的敏感膜表面要保持湿润，以防止阴极处的电解液干枯，在校准套底部有一块储水海绵（见图（5-1）），用户必须始终保持海绵的湿润，当海绵干燥时应滴加一些纯水（让海绵吸饱水，但不能有水流出来）。并且旋紧校准套帽子，使溶解氧电极在湿润条件下保存。
- 5.4.9. 装在溶氧电极中间的盐度电极（见图（5-1）），其表面镀有一层金属铂黑，可以降低电极极化，盐度电极表面不能擦拭，只能在水中晃动清洗，以免损坏铂黑镀层；用含有洗涤剂的温热水可以清洗电极上的有机成分沾污，也可以用酒精清洗。
- 5.4.10. 当仪器出现不正常时，请设置P7为“On”，使仪器恢复出厂设置状态，再进行校准和测试。

5.5. 参数设置：

5.5.1. 溶解氧参数设置一览表（表（5-1））

表（5-1）

提示符	参数设置项目	代码	参数
P1	分辨率选择		0.01/0.1 (mg/L 和 ppm) 0.1/1 (%)
P2	盐度校准		

P3	气压设置		
P4	温度单位选择		℃ °F
P5	背光显示时间设置	BL	0-1-3-6 min
P6	自动关机时间设置	AC	0-10-20 min
P7	恢复出厂设置		OFF-On (关闭-设置)

5.5.2. 分辨率选择 (P1)

- (a) 长按 MODE 键进入 P1 模式, 如图 (5-2) 所示;
- (b) 按 CAL 键选择分辨率: 0.01→0.1;
- (c) 按 MODE 键进入下一项参数设置或按  键确认并返回测量界面。

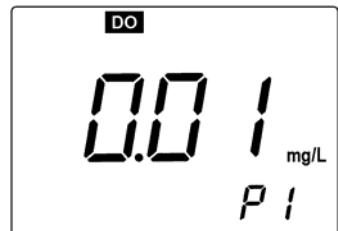


图 (5-2)

5.5.3. 盐度校准 (P2)

- (a) 在 P1 模式下按 MODE 键进入 P2 模式, 如图 (5-3) 所示。
- (b) 将溶氧电极浸入 12.88 mS/cm 校准溶液中, 液面应超过盐度电极, 搅动后静止放置, 等测量值稳定并显示“😊”图标时按 CAL 键, LCD 显示闪烁的“12.9”, 几秒钟后校准完成, 显示稳定的盐度值。
- (c) 按 MODE 键进入下一项参数设置或按  键确认并返回测量界面。

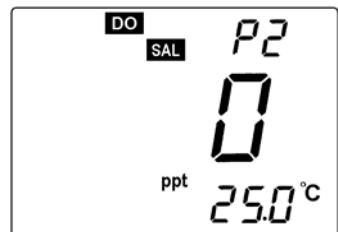


图 (5-3)

5.5.4. 气压设置 (P3)

- (a) 在 P2 模式下按 MODE 键进入 P3 模式, LCD 显示原先设定的气压值 (单位 kPa), 例如 101.3 kPa, 如图 (5-4) 所示。
- (b) 根据标准气压表显示的气压值, 按 CAL 键或  键

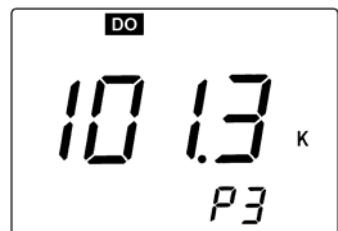


图 (5-4)

进行修改，长按  或  键可快速改变。

(c) 按  键进入下一项参数设置或按  键确认并返回测量模式。

5.5.5. 温度单位℃ / °F选择 (P4)

在 P3 模式下短按  键进入 P4 模式，其余操作参见 P13 第 4.5.7. 条。

5.5.6. 背光显示时间设置 (P5)

在 P4 模式下短按  键进入 P5 模式，其余操作参见 P13 第 4.5.8. 条。

5.5.7. 自动关机时间设置 (P6)

在 P5 模式下短按  键进入 P6 模式，其余操作参见 P13 第 4.5.9. 条。

注意：在溶解氧测量模式时，自动关机时间的出厂设置为 0，即自动关机功能关闭。

5.5.8. 恢复出厂设置 (P7)

在 P6 模式下短按  键进入 P7 模式，其余操作参见 P13 第 4.5.10. 条。

5.6. 更换隔膜帽：

当电极响应时间较长，测量值出现明显偏差时，或溶解氧电极的敏感膜出现皱纹、裂纹或破损，应按以下步骤及时更换隔膜帽。

- (a) 将隔膜帽旋下；
- (b) 将没有隔膜帽的电极用纯水洗净并甩干；
- (c) 用一块干净的绒布或纸巾，稍用力擦净阴极表面（黄金片）；
- (d) 取一只新的隔膜帽，缓慢注入电解液，不要出现气泡，如发现有气泡，应消除气泡；
- (e) 将隔膜帽放在桌面上，将电极垂直放入，缓慢的顺时针旋入，最后用力旋紧，此时多余的电解液会被挤出，用纸巾将其揩净，并将电极在纯水中洗净；
- (f) 检查电解液中不能有气泡（较小的气泡除外），否则应重新装配；
- (g) 使用电极和更换隔膜帽时，不要用手触摸敏感膜，因为皮肤的汗液和油脂会影

响膜的品质，使氧气渗透率降低。

5. 7. 零氧校准：

零氧校准一般只在更换新电极、更换隔膜帽和长期未使用的情况下才需要，一般平时不需要进行零氧校准。仪器出厂时已进行零氧校准，所以首次使用也不必进行零氧校准。零氧校准按以下步骤进行。

- (a) 配制 100ml 无氧水：在 100ml 烧杯中称取 5g 无水硫酸钠 (Na_2SO_3)，加纯水 100ml 搅拌至溶解，无氧水在 24 小时内有效；
- (b) 电极接入仪器极化 15min，并按第 5. 2. 1. 条进行校准；
- (c) 将电极放入无氧水中，按  键仪器进入校准模式，待仪器显示值 $< 0.15 \text{ mg/L}$ 时 ($< 5 \text{ min}$)，再按  键校准，LCD 显示闪烁的 0.0 %，几秒钟后校准完成，仪器显示 0.00 mg/L，将电极用纯水冲洗干净；
- (d) 如果 5min 内仪器已显示值 $< 0.02 \text{ mg/L}$ ，说明仪器的响应速度和残余电流这两个指标都很好，也就无需做零氧校准了，按  键返回测量模式；
- (e) 如果 5min 后仪器显示值 $> 0.15 \text{ mg/L}$ ，说明仪器的响应速度慢，残余电流大，可更换隔膜帽，或者旋下隔膜帽，取出附件中的抛光纸轻擦阴极的黄金片表面（要沿着黄金片的表面弧度擦拭），然后用干净的绒布或纸巾擦净阴极表面，用纯水洗净电极并甩干，在隔膜帽内添加一些电解液，重新装配旋紧，然后再按第 5. 2. 和第 5. 7. 条对仪器进行满度和零氧校准。

5. 8. 盐度校准：

仪器有盐度自动补偿功能，因此需要进行盐度校准，但盐度校准一般只在更换新电极和长期未使用的情况下才需要，平时不需要盐度校准。仪器出厂时已进行盐度校准，所以首次使用也不必校准。盐度校准的步骤请参见 P18 第 5. 5. 3. 条。

5. 9. 气压设置：

仪器有气压手动补偿功能，当仪器使用地点气压变化较大时，建议根据标准气压表的数值或不同地区的海拔高度再进行设置（参见附表V和附表VI），以保证气压补偿的精度。气压设置的步骤请参见P18第5.5.4.条。

6. 仪器成套性：

6. 1. SX726 型电导率/溶解氧测量电计	1 台
6. 2. 2301-S 塑壳电导电极	1 支
6. 3. DO500 溶解氧电极	1 支
6. 4. 1413 $\mu\text{S/cm}$ 电导率标准溶液 (50ml)	1 瓶
6. 5. D0503 隔膜帽 (溶解氧电极配用)	3 个
6. 6. D0502 溶解氧电极内溶液 (30ml)	1 瓶
6. 7. 阴极抛光纸	2 小张
6. 8. 小起子	1 把
6. 9. 备用 AA 电池	2 节
6. 10. 说明书	1 份
6. 11. 简要操作指南	1 份
6. 12. 装箱单	1 份
6. 13. 手提箱	1 个

7. 仪器保证事项:

7. 1. 仪器在正常使用条件下，自购买日起至一年内，仪器因制造不良而不能工作，可免费修理，更换零件或产品。
 7. 2. 除温度电极外，配套的其他电极，不属于保用期范围，但如果尚未使用的新电极发生故障，可免费修理或更换。
 7. 3. 以上担保不适用由于用户不正确使用、不适当维护或自行打开修理引起的损坏。
-





附表 I 仪器参数设置一览表

模式	提示符	参数设置项目	代码	参 数
电导率	P1	标准溶液系列选择	SOL	CH(146. 6 μ S/cm、1408 μ S/cm、12. 85mS/cm、111. 3 mS/cm) USA(84 μ S/cm、1413 μ S/cm、12.88 mS/cm、111.9 mS/cm)
	P2	电极常数选择	Con	0. 1, 1, 10。
	P3	基准温度选择	TrEF	25℃ 20℃ 18℃
	P4	温度补偿系数设置	TCC	0.00~9.99%
	P5	电极常数设定	EC	
	P6	温度单位选择		℃ °F
	P7	背光显示时间设置	BL	0-1-3-6 min
	P8	自动关机时间设置	AC	0-10-20 min
	P9	恢复出厂设置		OFF-On (关闭-设置)
溶解氧	P1	分辨率选择		0.01/0.1 (mg/L 和 ppm) 0.1、1 (%)
	P2	盐度校准		
	P3	气压设置		
	P4	温度单位选择		℃ °F
	P5	背光显示时间设置	BL	0-1-3-6 min
	P6	自动关机时间设置	AC	0-10-20 min
	P7	恢复出厂设置		OFF-On (关闭-设置)

附表II 仪器恢复出厂设置一览表

模式	提示符	参数设置项目	出厂设置内容	非出厂设置图标
电 导 率	P2	电极常数类型选择	K=1	
	P3	基准温度选择	25℃	
	P4	温度补偿系数设置	2.0%	

附表III 代码符号及缩写一览表

代码及缩写	英 语	解 释
	Solution	标准溶液
	China	中国系列标准
	USA	欧美系列标准
	Constant	电极常数选择
	Temperature Compensation Coefficient	温度补偿系数设置
	Temperature Reference	基准温度选择
	Constant Calibration	电极常数设定
	End	
	Calibration	
	Conductivity	
	Dissolved Oxygen	
	Resistivity	
	Total Dissolved Solid	
	Salinity	

附表IV 氧在不同温度水中的饱和含量表

温度 °C	溶解氧 mg/L	温度 °C	溶解氧 mg/L	温度 °C	溶解氧 mg/L
0	14.64	16	9.86	32	7.30
1	14.22	17	9.66	33	7.18
2	13.82	18	9.46	34	7.07
3	13.44	19	9.27	35	6.95
4	13.09	20	9.08	36	6.84
5	12.74	21	8.90	37	6.73
6	12.42	22	8.73	38	6.63
7	12.11	23	8.57	39	6.53
8	11.81	24	8.41	40	6.43
9	11.53	25	8.25	41	6.34
10	11.26	26	8.11	42	6.25
11	11.01	27	7.96	43	6.17
12	10.77	28	7.82	44	6.09
13	10.53	29	7.69	45	6.01
14	10.30	30	7.56		
15	10.08	31	7.43		

附表V 氧在不同气压中的饱和含量

大气压		溶解氧 (mg/L)		
mmHg	kPa	15℃	25℃	35℃
750	100.00	9.94	8.14	6.85
751	100.13	9.96	8.15	6.86
752	100.26	9.97	8.16	6.87
753	100.40	9.98	8.17	6.88
754	100.53	9.99	8.18	6.89
755	100.66	10.00	8.20	6.90
756	100.80	10.01	8.21	6.91
757	100.93	10.03	8.22	6.92
758	101.06	10.04	8.23	6.93
759	101.20	10.07	8.24	6.94
760	101.33	10.08	8.25	6.95
761	101.46	10.09	8.26	6.96
762	101.60	10.11	8.27	6.97
763	101.73	10.12	8.28	6.98
764	101.86	10.14	8.30	6.99
765	102.00	10.15	8.31	7.00
766	102.13	10.16	8.32	7.01
767	102.26	10.18	8.33	7.02
768	102.40	10.19	8.34	7.02
769	102.53	10.21	8.35	7.03
770	102.66	10.22	8.36	7.04
771	102.80	10.23	8.37	7.05
772	102.93	10.25	8.39	7.06
773	103.06	10.26	8.40	7.07
774	103.19	10.28	8.41	7.08
775	103.33	10.29	8.42	7.09

mmHg 与 kPa 换算： mmHg × 0.13333=kPa

$$DO_{pt} = P \times DO_t \div 760$$

式中： DO_{pt} — 在t温度、P大气压时溶解氧浓度， mg/L；

P — 大气压， mmHg；

DO_t — 在t温度， 760mmHg气压时溶解氧浓度， mg/L；

760 — 大气压， mmHg。

附表VI 氧在不同海拔高度中的饱和含量

高度		大气压力		DO	高度		大气压力		DO
英尺	公尺	kPa	mmHg	mg/l	英尺	公尺	kPa	mmHg	mg/l
0	0	101.3	760	8.25	7500	2287	77.1	579	6.28
500	152	99.34	746	8.09	8000	2439	75.63	568	6.16
1000	305	97.6	733	7.95	8500	2591	74.44	559	6.06
1500	457	95.87	720	7.81	9000	2744	72.97	548	5.94
2000	610	94.28	708	7.68	9500	2896	71.64	538	5.83
2500	762	92.54	695	7.54	10000	3049	70.17	527	5.71
3000	915	90.95	683	7.41	10500	3201	68.84	517	5.61
3500	1067	89.35	671	7.28	11000	3354	67.38	506	5.49
4000	1220	87.75	659	7.15	12000	3659	66.58	500	5.42
4500	1372	86.15	647	7.02	13000	3963	65.78	494	5.36
5000	1524	84.56	635	6.89	14000	4268	64.98	488	5.29
5500	1677	83.09	624	6.77	15000	4573	64.18	482	5.23
6000	1829	81.63	613	6.65	16000	4878	63.38	476	5.16
6500	1982	80.03	601	6.52	17000	5183	62.58	470	5.10
7000	2134	78.56	590	6.40	18000	5488	61.79	464	5.03

地址：上海市桂平路 471 号 4 幢 3 楼（漕河泾开发区内） 邮编：200233

电话：021-63362480

传真：021-64956880

网址：www.shsan-xin.com

E-mail:wxmab@shsan-xin.com